

**Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266
від 16 грудня 2020 року**

***ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків - мобільний
відеобронхоскоп (НК 024:2019 - Класифікатор медичних виробів: 17662 «Гнучкий
відеобронхоскоп»)***

09.05.2022 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», ДУ «ГМЦ МВС України» (код ЄДРПОУ 08735882; адреса: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116) надає інформацію про процедуру відкритих торгів (з особливостями).

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків - мобільний відеобронхоскоп (НК 024:2019 - Класифікатор медичних виробів: 17662 «Гнучкий відеобронхоскоп»):

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель UA-2023-05-09-013696-а.

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної записки №33/4-1056 від 09.05.2023 щодо проведеного інтернет моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, орієнтовна вартість закупівлі становить – 1 150 000,00 грн з ПДВ.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків - мобільний відеобронхоскоп (НК 024:2019 - Класифікатор медичних виробів: 17662 «Гнучкий відеобронхоскоп»):

№ з/п	Вимоги
	1 Мобільний відеобронхоскоп - 1 комплект • Напрямок огляду - 0° • Поле огляду - 90° • Глибина різкості від 3-50 мм. • Діаметр дистального кінця не менше 5,1 мм • Діаметр ввідної трубки не більше 5,2 мм • Діаметр внутрішнього каналу не менше 2,6 мм • Кути вигину робочої частини не менше – 180° вгору, 120° униз • Довжина робочої частини не більше 600 мм • Загальна довжина не менше 910 мм • Мінімальна відстань бачення від дистального кінця ендоскопа до об'єкта не менше 3 мм. • Вбудований кольоровий РК-монітор, з діагоналлю не більше 3,5 дюйма. • Обертання вбудованого монітору на 90° вліво, 90° вправо • Кут нахилу монітора від 0 до 120° • Вбудоване LED джерело світла • Наявність в комплекті карти пам'яті формату SD ємністю до 2 GB • Можливість збереження стоп кадрів під час проведення дослідження • Можливість запису статичних зображень на SD карту не менше 3500 шт • Можливість збереження відеозаписів під час проведення дослідження • Можливість запису відео на SD карту в режимі HQ не менше 240 хв • Наявність на секції монітора не менше 5 кнопок керування зображенням • Змінний літій-іонний акумулятор, в комплектації не менше 2-х штук. • Напруга літій-іонного акумулятора не менше 3,6 В. • Ємність акумулятора не менше 1350 мА год.

	• Час безперервної, автономної роботи апарата на одному заряді акумулятора, повинен становити не менше 60 хвилин. • Наявність в комплекті поставки зарядного пристрою • Наявність в комплекті поставки одноразового аспіраційного клапана в кількості 20шт. • Наявність в комплекті поставки ковпачка для стерилізації • Наявність в комплекті поставки комбінованої щітки для очищення вхідного отвору каналу та порту інструментального каналу в кількості не менше 3 шт • Наявність в комплекті поставки адаптеру для аспіраційного очищення • Наявність в комплекті поставки клапанів для біопсійного каналу не менше 20 шт.
--	--

Товар має постачатися і розвантажуватись транспортом та силами Учасника у робочий час Замовника.

Поставка проводиться окремими партіями з дотриманням вимог до зберігання та транспортування товару.

інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна підтверджена відповідними документами (декларація відповідності, підтвердження відповідності запропонованого товару щодо кількості та медико-технічним вимогам тощо);

монтаж, інсталяція, ознайомлення з функціоналом обладнання та навчання персоналу користування обладнанням проводиться учасником-переможцем за його рахунок (надати гарантійний лист в довільній формі);

запропоновані вироби повинні бути дозволені до застосування на території України. (на кожне найменування надати декларації відповідності, свідоцтво про якість або інші документи, що підтверджують можливість застосування виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту.


Якість товару: товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів якості (сертифікатів відповідності), декларацією відповідності (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

Постачальник бере на себе обов'язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів.

Строк поставки товару – 90 календарних днів з дня укладення договору про закупівлю. Місце поставки: вулиця Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Закупівля здійснюється з метою належного забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам установи.

Уповноважена особа

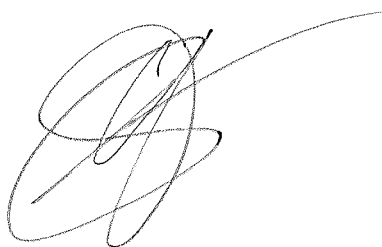

Юлія СТЕЛЬНИКОВИЧ